


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-26 19:31:28
Название пробы	1-1
Номер хроматограммы	14013
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
17.557		0		5.432	24.759
19.683		0		3.727	16.987
21.769		0		6.398	29.162
26.364		0		6.383	29.092

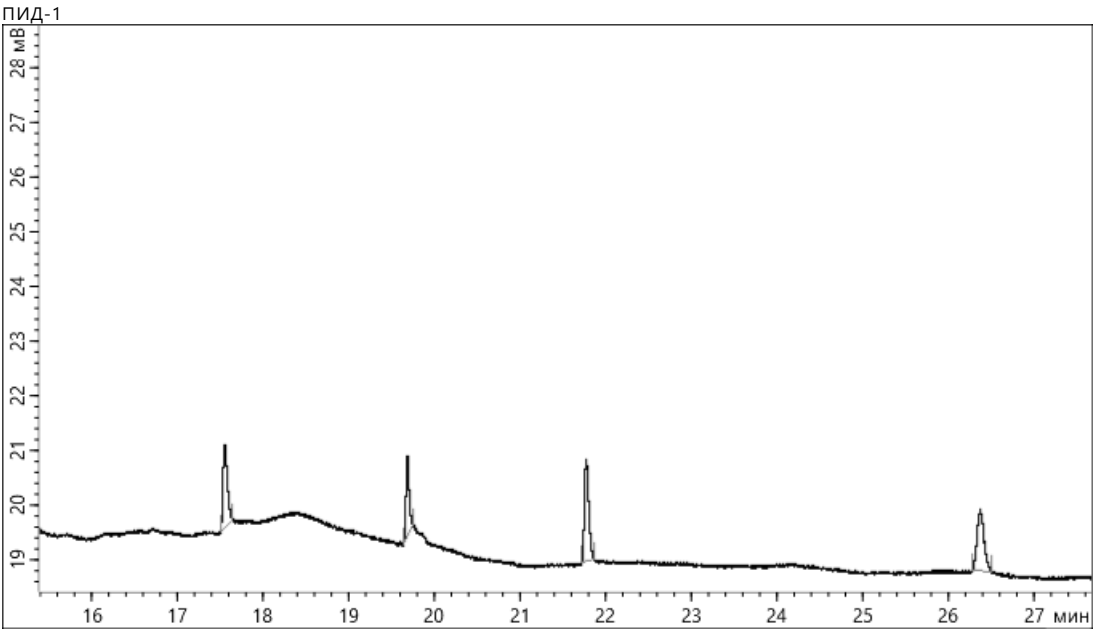


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-28 17:21:52
Название пробы	1-2
Номер хроматограммы	14031
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5km
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
17.547		0		4.565	21.712
19.679		0		3.354	15.955
21.767		0		6.528	31.049
26.351		0		6.577	31.284

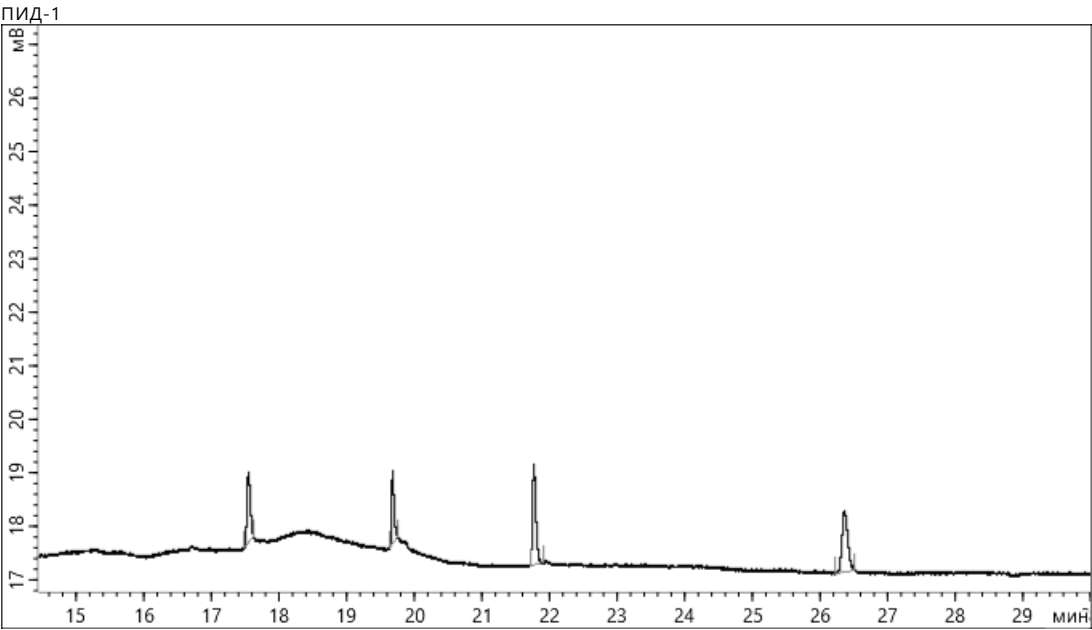


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-26 20:38:44
Название пробы	2-1
Номер хроматограммы	14017
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
17.529		0		7.699	23.784
19.669		0		8.686	26.833
21.761		0		9.107	28.135
26.347		0		6.878	21.248

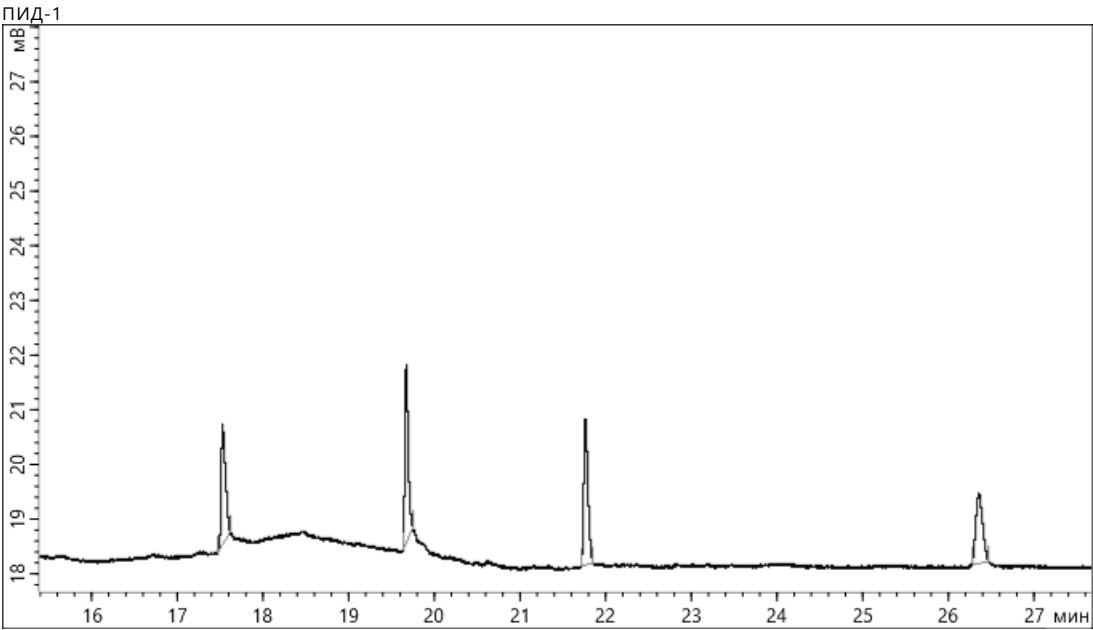


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-28 18:55:53
Название пробы	2-2
Номер хроматограммы	14034
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
17.527		0		7.348	27.266
19.664		0		7.263	26.948
21.761		0		6.761	25.087
26.359		0		5.579	20.699

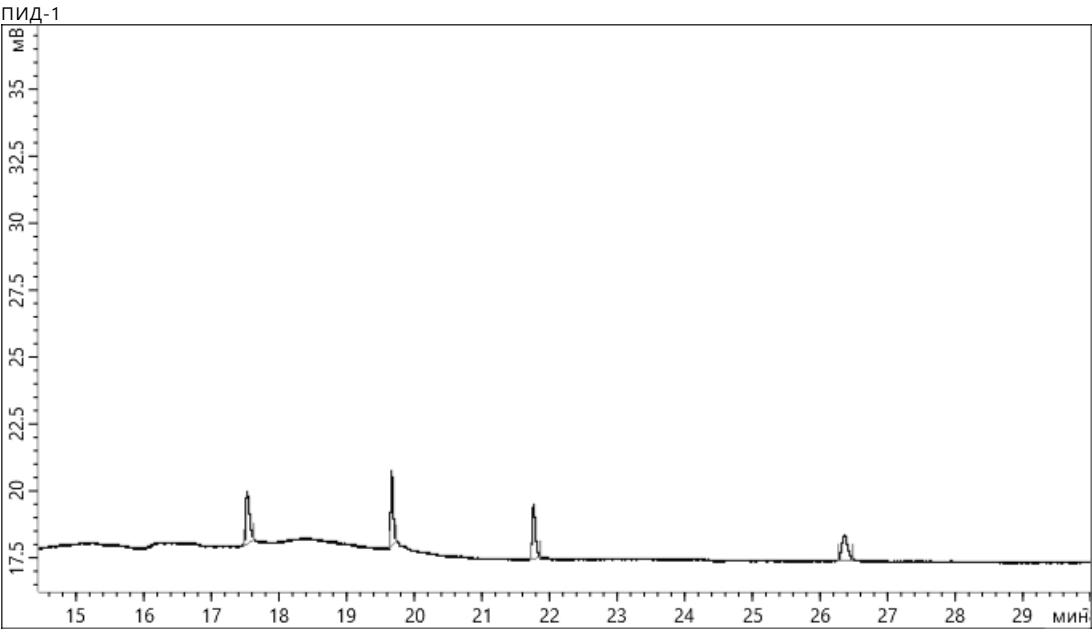


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-26 21:17:24
Название пробы	3-1
Номер хроматограммы	14018
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
19.683		0		0.457	14.049
21.756		0		1.661	51.058
26.345		0		1.135	34.894

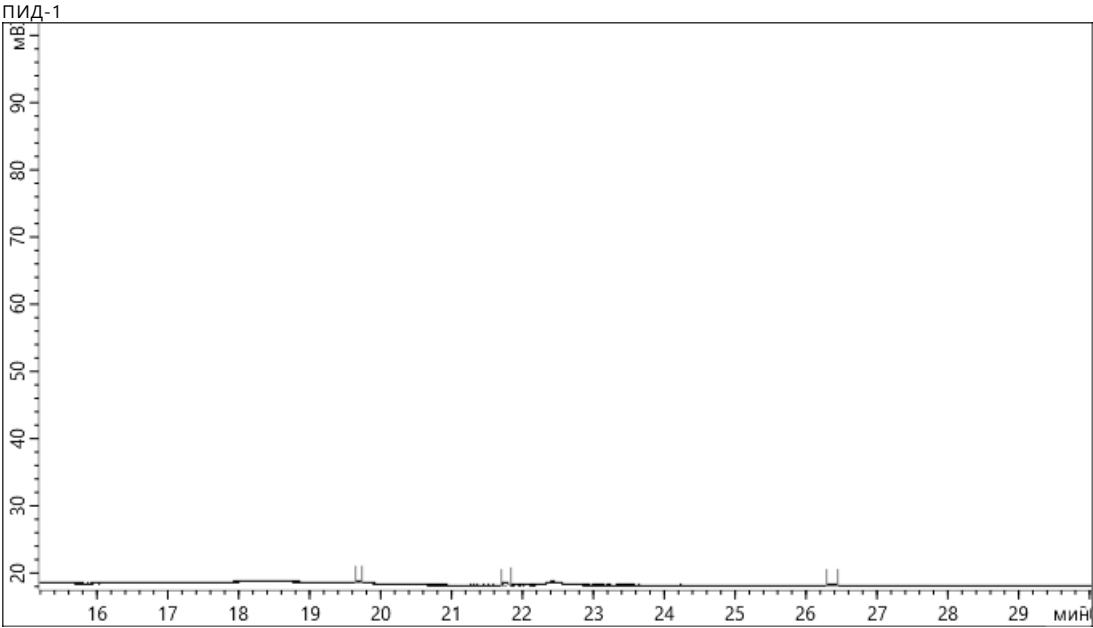


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-28 20:25:31
Название пробы	3-2
Номер хроматограммы	14036
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
19.695		0		0.160	9.889
21.779		0		0.838	51.872
26.369		0		0.617	38.238

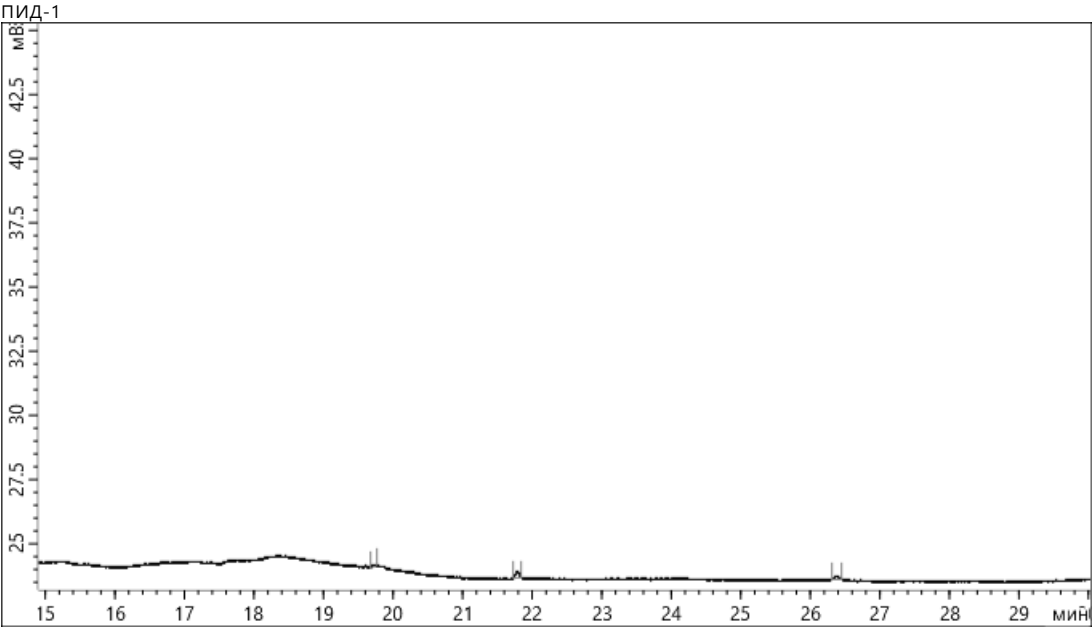


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-26 22:05:58
Название пробы	4-1
Номер хроматограммы	14021
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
19.707		0		0.194	8.465
21.777		0		1.109	48.381
26.357		0		0.989	43.153

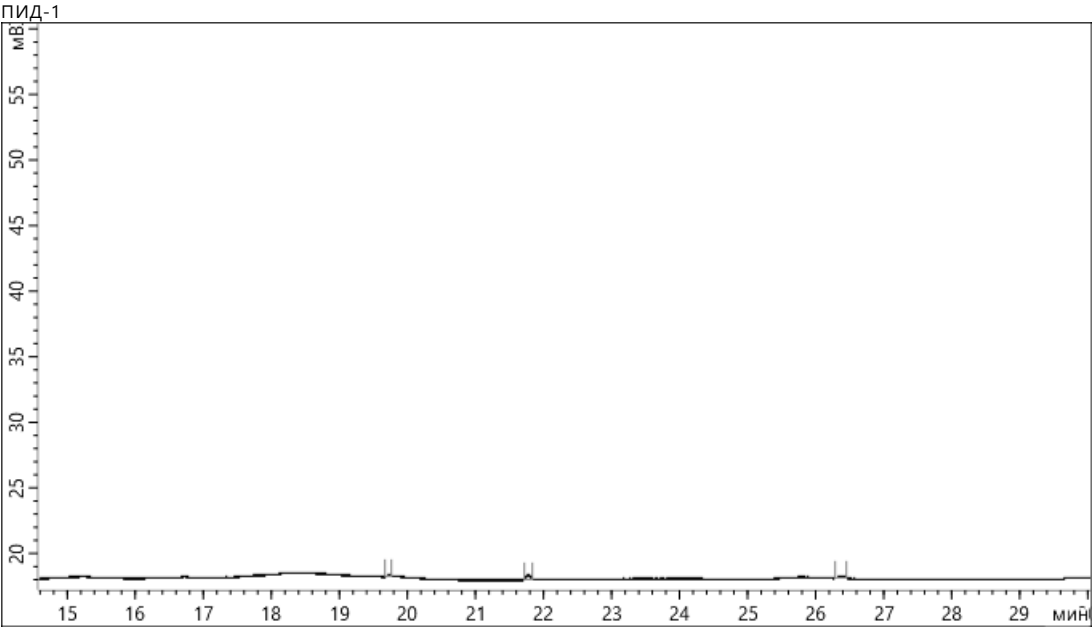


Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-28 21:46:04
Название пробы	4-2
Номер хроматограммы	14038
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
19.677		0		0.126	8.279
21.761		0		0.772	50.732
26.338		0		0.623	40.989

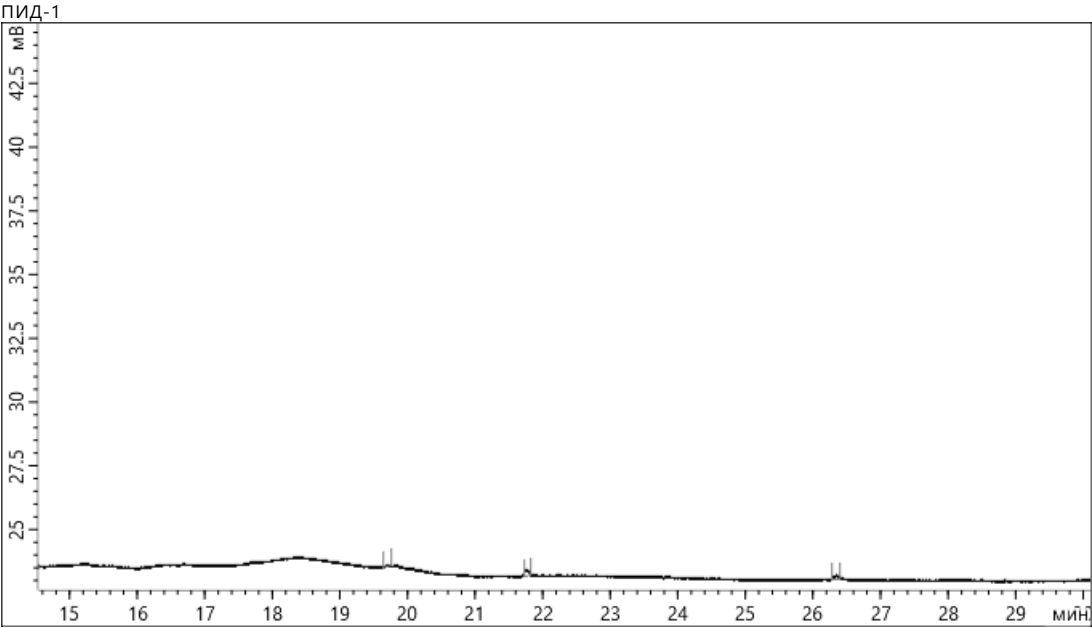

Отчёт ГХ анализа

Параметр	Значение
Дата и время анализа	2026-06-28 16:44:44
Название пробы	исходный
Номер хроматограммы	14030
Объём пробы	0.9660
Разведение пробы	1
ID оборудования	Хроматэк-Кристалл 5000 (исполнение 1) Колонка HP INNOWax 60m*0.32mm*0.5µm
Метод	C:\Analytic 3\Projects\2024-03-09\methods\2024-05-23_Град.mthx

Компоненты

Время, мин	Компонент	Концентрация	Ед. конц.	Площадь, мВ*с	Площадь, %
21.787		0		0.155	56.288
26.371		0		0.120	43.712

